KERN

BROCHURE PRODUIT

ÉTALONNAGE & SERVICE 961-230

Date: 30.04.2025

FRANCAIS

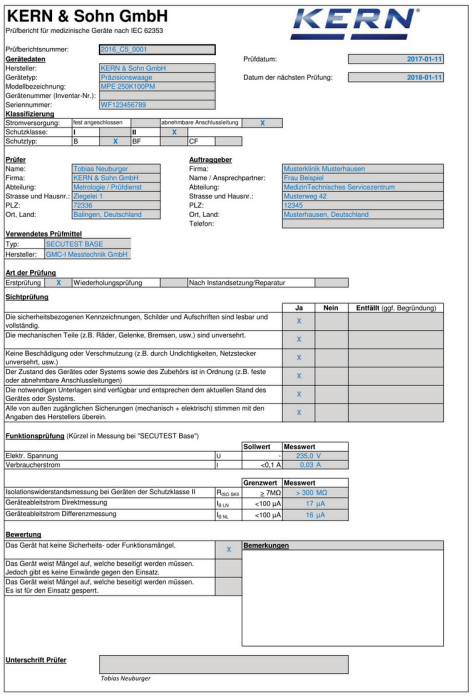

KERN & Sohn GmbH

Prüfbericht für medizinische Geräte nach IEC 62353

KERN

Prüfberichtsnummer: 2016_05_0001

Gerätedaten

Hersteller: KERN & Sohn GmbH
Gerätetyp: Präzisionswaage
Modellbezeichnung: MPE 250K100PM
Gerätenummer (Inventar-Nr.):
Seriennummer: WF123456789

Prüfdatum: 2017-01-11
Datum der nächsten Prüfung: 2018-01-11

Klassifizierung

Stromversorgung:	Netz angeschlossen		abnehmbare Anschlussleitung	X
Schutzklasse:	I	II	X	
Schutztyp:	B	X BF	CF	

Prüfer

Name: Tobias Neuburger
Firma: KERN & Sohn GmbH
Abteilung: Metrologie / Prüflabrat
Strasse und Hausnr.: Ziegelei 1
PLZ: 72336
Ort, Land: Balingen, Deutschland

Auftraggeber

Firma: Musterklinik Musterhausen
Name / Ansprechpartner: Frau Beispiel
Abteilung: MedizinTechnisches Servicezentrum
Strasse und Hausnr.: Musterweg 42
PLZ: 12345
Ort, Land: Musterhausen, Deutschland
Telefon:

Verwendetes Prüfmittel

Typ: SECUTEST BASE
Hersteller: GMC-I Messtechnik GmbH

Art der Prüfung

Erstprüfung	X	Wiederholungsprüfung		Nach Instandsetzung/Reparatur	

Sichtprüfung

	Ja	Nein	Entfällt (ggf. Begründung)
Die sicherheitsbezogenen Kennzeichnungen, Schilder und Aufschriften sind lesbar und vollständig.	X		
Die mechanischen Teile (z.B. Räder, Gelenke, Bremsen, usw.) sind unversehrt.	X		
Keine Beschädigung oder Verschmutzung (z.B. durch Undichtigkeiten, Netzstecker unversehrt, usw.)	X		
Der Zustand des Gerätes oder Systems sowie des Zubehörs ist in Ordnung (z.B. feste oder abnehmbare Anschlussleitungen)	X		
Die notwendigen Unterlagen sind verfügbar und entsprechen dem aktuellen Stand des Gerätes oder Systems.	X		
Alle von außen zugänglichen Sicherungen (mechanisch + elektrisch) stimmen mit den Angaben des Herstellers überein.	X		

Funktionsprüfung (Kürzel in Messung bei "SECUTEST Base")

		Sollwert	Messwert
Elektr. Spannung	U		235.0 V
Verbraucherstrom	I	<0.1 A	0.03 A

		Grenzwert	Messwert
Isolationswiderstandsmessung bei Geräten der Schutzklasse II	$R_{ISO\ bes}$	≥ 7MΩ	> 300 MΩ
Geräteableitstrom Direktmessung	$I_{B\ DI}$	<100 µA	17 µA
Geräteableitstrom Differenzmessung	$I_{B\ NL}$	<100 µA	16 µA

Bewertung

		Bemerkungen
Das Gerät hat keine Sicherheits- oder Funktionsmängel.	X	
Das Gerät weist Mängel auf, welche beseitigt werden müssen. Jedoch gibt es keine Einwände gegen den Einsatz.		
Das Gerät weist Mängel auf, welche beseitigt werden müssen. Es ist für den Einsatz gesperrt.		

Unterschrift Prüfer

Tobias Neuburger

QYC133 (rev 1.1) STK _Formblatt Go; 14.11.2016

Contrôle technique de sécurité (protocole STK)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Cliquez ici pour plus d'informations

FRANCAIS

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	961-230
Model-Serie	961
Assortiment	Calibration & Service
Type de produit	Service interne Nouveau
Groupe de produits	Autres services (initial) inhouse
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761157446
Numéro de tarif douanier	84239010

Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard