


FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN RMTA-4002

Fecha: 29.01.2025

ESPAÑOL

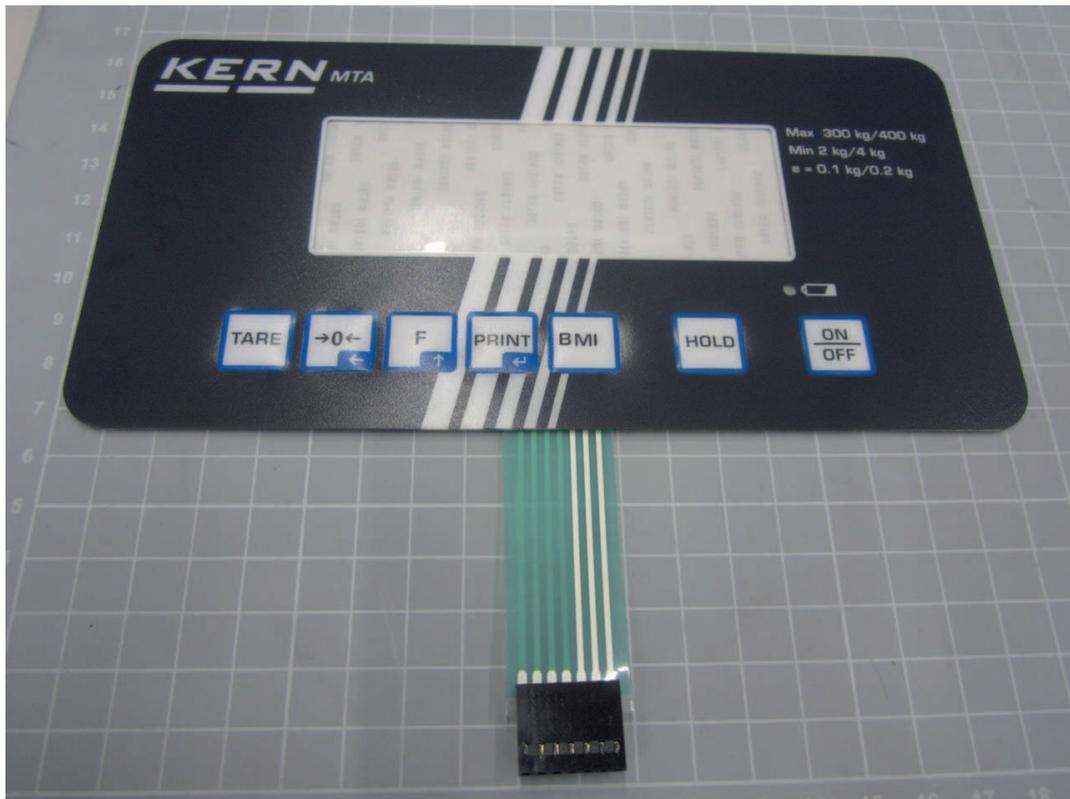

Puede montarse en todos los bancos de prueba SAUTER, la ilustración muestra los accesorios opcionales y el banco de pruebas manual SAUTER TVL-XS

CONTACT

 Dirección

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Teléfono y fax

Teléfono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Correo electrónico : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

Lámina de teclado RMTA-4002

ESPECIFICACIÓN

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Modelo de código de artículo | RMTA-4002 |
| Serie de modelos | MTA |
| Surtido | KERN |
| Tipo de producto | Productos médicos |
| Grupo de productos | Básculas para pasamanos |
| Tipo de uso del producto | Pieza de recambio |
| Código EAN (Modelo) | 404576 1206885 |
| Fecha de inicio prevista | unbestimmt-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 90160090 |

Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|------------------|----------------------|
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Plazo de entrega | 1 d |

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

| Nombre del modelo | Capacidad de pesada | Legibilidad | Valor de verificación (e) | Dimensiones carcasa |
|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| RMTA-8002 | | | | |
| RMTA-3001 | | | | |
| RMTA-4001 | | | | |
| RMTA-4002 | | | | |
| RMTS-8003 | | | | |
| RMTA-3002 | | | | |
| RMTP-4001 | | | | |
| RMTS-8006 | | | | |
| RMTS-4001 | | | | |
| RMTA-9002 | | | | |